


峰检测报告

打印日期和时间: 2025/01/14 16:57:56

文件名: File\_250114\_165609 - CorrectionData

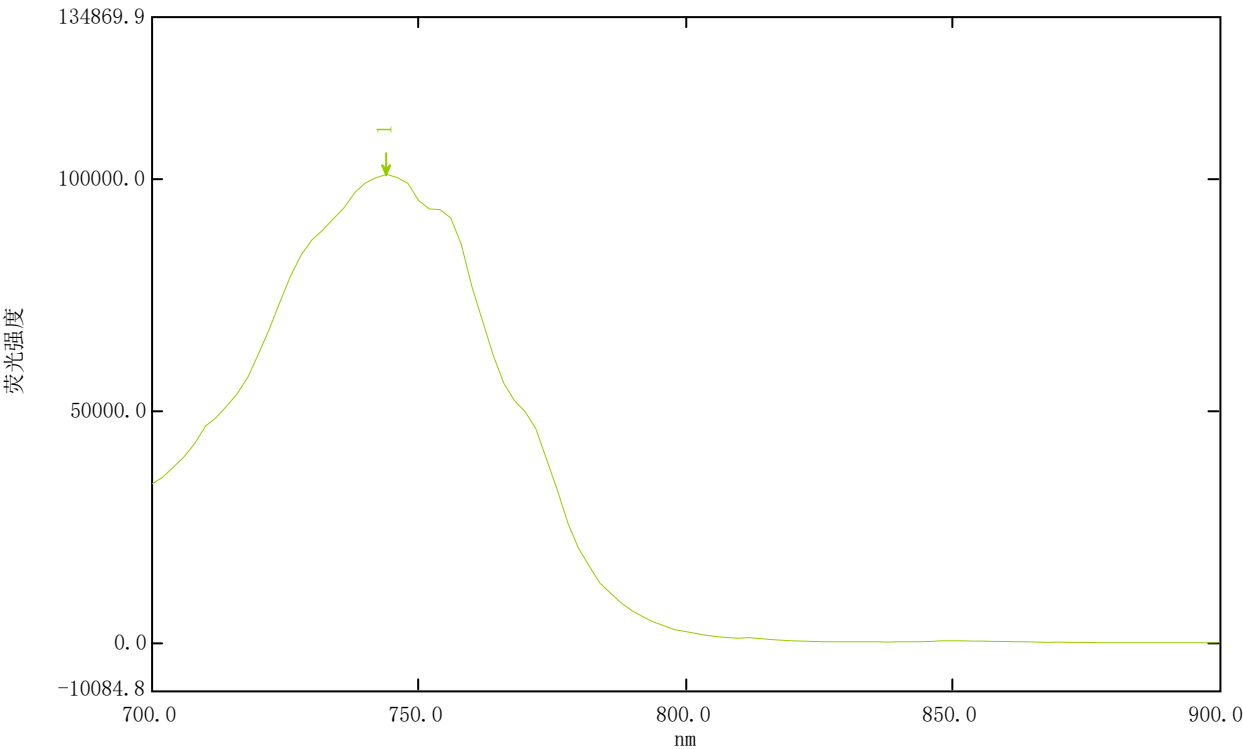

[峰检测表]

阈值: 1000.000  
点数: 5

| No. | P/V | Wavelengt | 荧光强度     | 描述 |
|-----|-----|-----------|----------|----|
| 1   |     | 744.0     | 100975.0 |    |

软件信息  
软件名称: LabSolutions RF  
版本: 1.15

数据信息  
数据: 非原始  
样品名称:  
样品ID:  
Option:  
分析者:  
创建日期和时间: 2025/01/14 16:56:50  
注释:

仪器信息  
仪器名称: RF-6000  
仪器类型: RF-6000系列  
型号(S/N): RF-6000 (A40245701600SA)

[测定]  
光谱类型: 激发光谱  
激发光波长 开始: 700.0 nm  
激发光波长 结束: 900.0 nm  
发射光波长: 774.0 nm  
数据间隔: 2.0 nm  
扫描速度: 6000 nm/min

[仪器]  
激发光带宽: 5.0 nm  
发射光带宽: 5.0 nm  
灵敏度: Auto

[附件]  
附件: 无

[自动打印]  
自动打印: 不执行  
报告文件: